

## Medical MDS-250, MDS-300 和 MDS-400 系列产品变更通知

MDS-250, MDS-300 和 MDS-400 系列医疗电源 Molex 控制用连接器 (CN 101) 即将停产 (EOL)。因此, 台达将把连接器制造商改为 JST。


搭配 Molex 连接器的产品最后接单时间为 2021/09/30。

请联系当地业务代表取得产品购买的详细讯息。并可在 [DeltaPSU](http://DeltaPSU) 网站上获取更新的技术规格书。

### 1. CN101 连接器变更

修改前	修改后
<b>电源端</b> Molex 104141-1010 Rating: DC50V/1A	<b>电源端</b> JST BM10B-SRSS-TB1(LF)(SN) Rating: DC50V/1A
<b>系统端</b> Housing: Molex 1041421000 Terminal: Molex 1045398002	<b>系统端</b> Housing: JST SHR-10V-S-B & SHR-10V-S Terminal: JST SSH-003T-P0.2-H

### 2. 产品外观变更

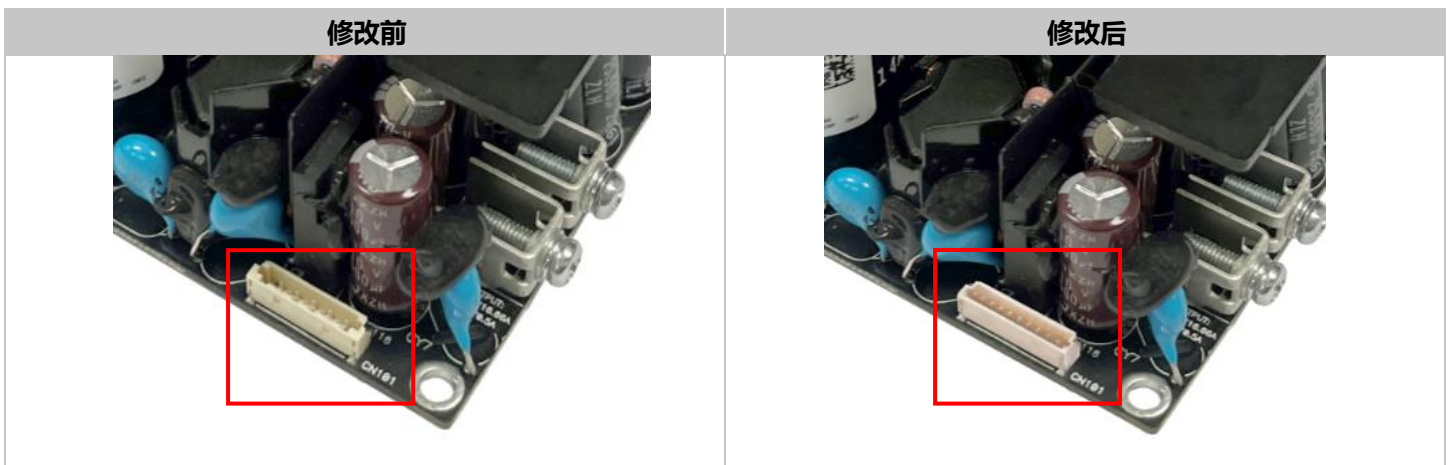

### 3. 产品版本变更

输出功率	产品型号	更新前版本 (Molex 连接器)	更新后版本 (JST 连接器)
250W	MDS-250APB12 AA	04	05
	MDS-250APB12 AB	02	03
	MDS-250ADB12 AA	02	03
	MDS-250ADB12 AB	02	03
	MDS-250APB24 AA	02	03
	MDS-250APB24 AB	02	03
	MDS-250ADB24 AA	02	03
300W	MDS-300APB12 AA	04	05
	MDS-300ADB12 AA	02	03
	MDS-300APB18 AA	04	05
	MDS-300APB18 AB	00	01
	MDS-300ADB18 AA	03	04
	MDS-300ADB18 AB	00	01
	MDS-300APB24 AA	03	04
	MDS-300APB24 AE	02	03
	MDS-300ADB24 AA	03	04
	MDS-300ADB24 AB	03	04
	MDS-300APB48 AA	03	04
	MDS-300APB48 AB	00	01
	MDS-300ADB48 AA	02	03
	MDS-300ADB48 AB	00	01
400W	MDS-400APB12 AA	02	03
	MDS-400APB12 AB	00	01
	MDS-400ADB12 AA	02	03
	MDS-400APB24 AA	02	03
	MDS-400APB24 AB	00	01
	MDS-400ADB24 AA	02	03
	MDS-400ADB24 AB	00	01